

JAMT-QC を用いた参加申し込み・結果入力・結果確認の手順について

1. JAMT-QC に施設登録がない場合の申請方法

- ① <https://www.jamt.or.jp/>にアクセス
- ② 臨床検査精度管理調査をクリック



- ③ JAMT-QC 参加施設向けシステムをクリック



- ④ 施設登録のない方をクリック



- ⑤ 施設名また施設名カナを入力し、施設検索をクリックする。施設登録がないことを確認して、
「検索しても該当施設がない場合（施設申請します）」をクリック。
必要事項を入力して「申請して閉じる」をクリック

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 各種申請 Official Application Form

>> 施設申請

>> 施設パスワード発行申請

施設申請

最新のデータベースで該当する施設があるかどうか、まず検索して下さい。
検索して該当する施設がない場合は、施設申請へ進んで下さい。
検索して該当する施設がある場合は、該当する施設の「パスワード発行申請」へ進んで下さい。

施設名または施設名カナ 施設検索

パスワード発行	施設番号
---------	------

- ⑥ 後日、申請したメールアドレスにお知らせが届く。メールに従って登録を完了する。

2. 月例サーベイの申し込み方法

- ① <https://www.jamt.or.jp/>にアクセス
- ② 臨床検査精度管理調査をクリック




- ③ JAMT-QC 参加施設向けシステムをクリック



- ④ 施設番号・パスワードを入力してログイン



⑤ 事務メニューをクリック

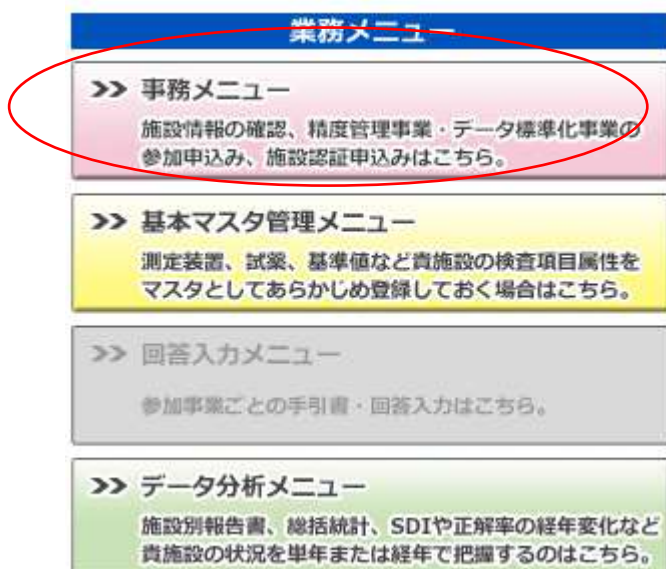

⑥ 精度管理事業のタブをクリック



⑦ 「令和7年度 福岡県臨床検査精度管理調査」の申し込みをクリック

申込	年度	コード	事業
申込み	令和7	254001	令和7年度 福岡県臨床検査技師会精度管理調査

毎月、前月 21 日～10 日の期間に参加申し込みをする必要があります。


(試料配布の都合から 5 月と 1 月は実施いたしません)

参加申し込みを忘れると、結果の入力ができませんので気を付けてください。

3. 使用機器や試薬などの入力方法

今年度より JAMT-QC に登録した施設は、使用機器や試薬などの入力が必要となります。
回答期間を待たずに事前に登録することができます。

- ① 基本マスタ管理メニューをクリック

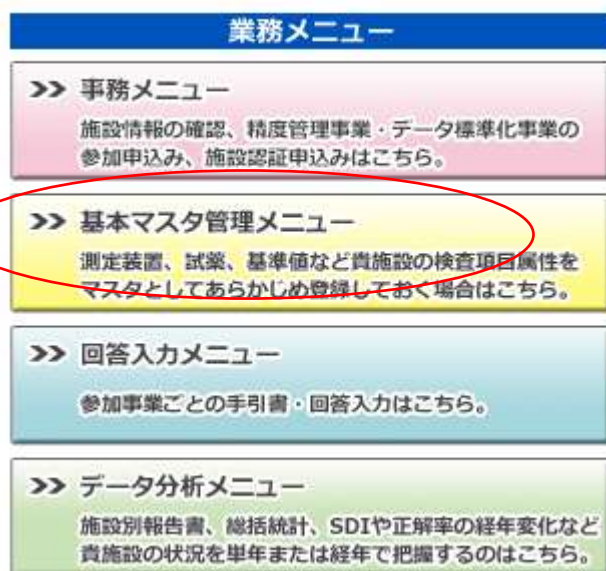


- ② 検査項目別設定 or 一括設定を用いて、試薬・機器・基準範囲などの入力を行ってください。
内部精度管理報告の入力は必要ありません。




4. 月例サーベイ結果入力方法

サーベイ結果の入力はJAMT-QCより毎月11日～20日の期間に入力してください。(5月と1月を除く)

① 回答入力メニューをクリック

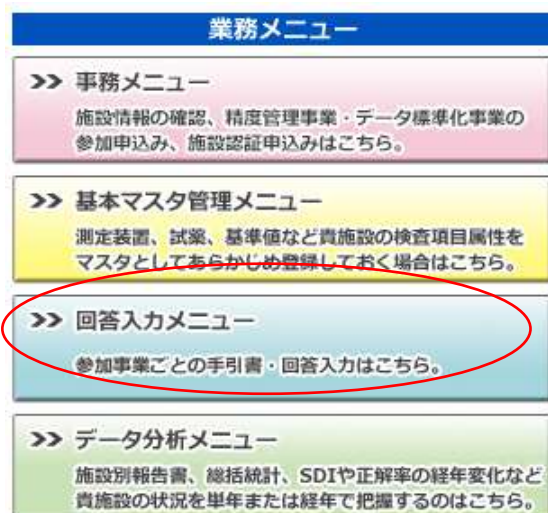

② 試料到着確認・受検項目設定をクリックして、試料到着済みに✓、到着日を入力

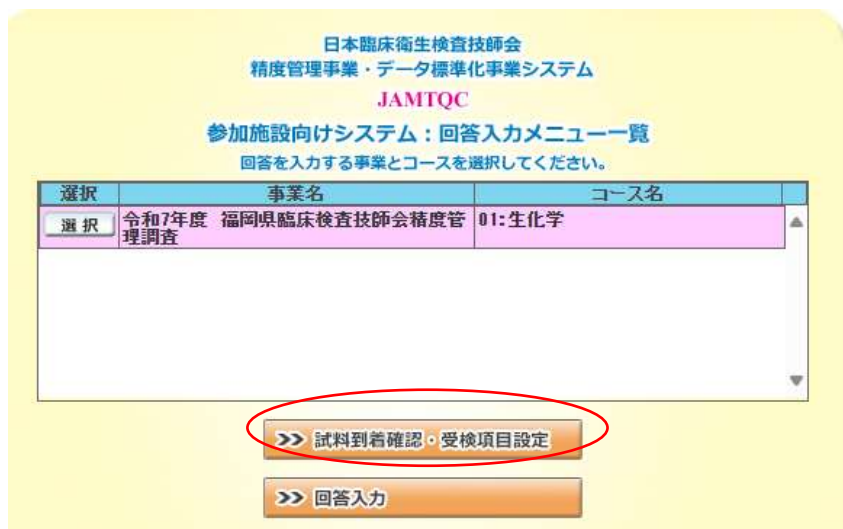

③ 回答入力をクリックして、各項目に結果入力

日本臨床衛生検査技師会
精度管理事業・データ標準化事業システム
JAMTQC

参加施設向けシステム：回答入力メニュー一覧
回答を入力する事業とコースを選択してください。

選択	事業名	コース名
選択	令和7年度 福岡県臨床検査技師会精度管理調査	01:生化学

>> 試料到着確認・受検項目設定

>> 回答入力

>> トップメニュー >> ログアウト

Copyright©日本臨床衛生検査技師会 All Rights Reserved.

5. サーベイ結果の確認

サーベイ結果の確認は JAMT-QC のデータ分析メニューにて行ってください。

業務メニュー

>> 事務メニュー
施設情報の確認、精度管理事業・データ標準化事業の参加申込み、施設認証申込みはこちら。

>> 基本マスタ管理メニュー
測定装置、試薬、基準値など貴施設の検査項目属性をマスタとしてあらかじめ登録しておく場合はこちら。

>> 回答入力メニュー
参加事業ごとの手引書・回答入力はこちら。

>> データ分析メニュー
施設別報告書、総括統計、SDIや正解率の経年変化など貴施設の状況を半年または経年で把握するのはこちら。